Головка для сканирования для cad/cam систем с уровня имплантата	Аналог имплантатов цифровой	Головка для сканирования и аналог разъемных головок для cad/cam систем	Заготовки для фрезеровки индивидуальных абатментов (Pre-mill)
Zirkonzahn 3shape и Exocad			
Zirkonzahn 3shape и Exocad			
 Zirkonzahn 3shape и Exocad			
 3shape и Exocad			

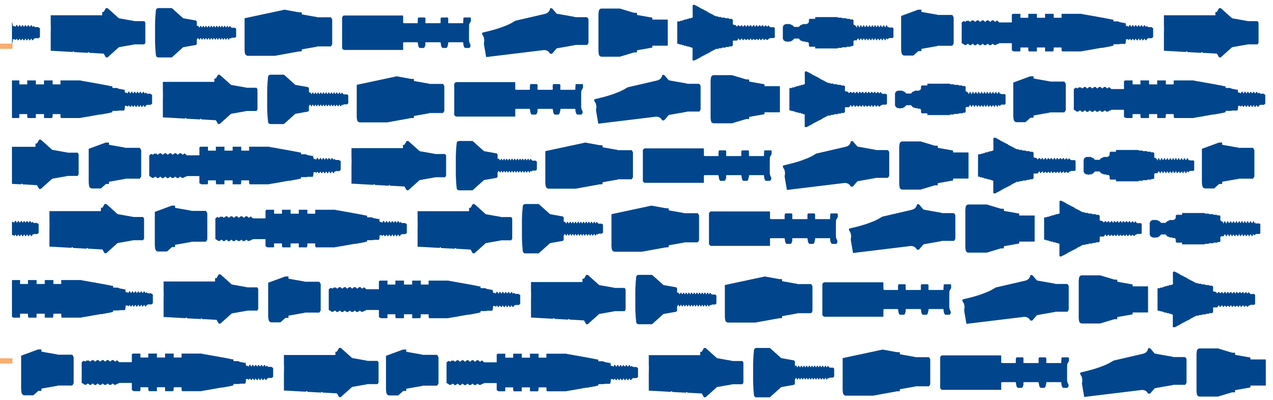

КОНМЕТ
Россия,
125413 Москва,
Онежская ул, д. 24, стр. 1
Тел. (495) 234-91-13
Факс (495) 232-19-31
conmet@conmet.ru
www.conmet.ru

OP_v.23-02.2024

г. Санкт-Петербург
191015, Шпалерная ул, 54
офис B51
Тел. (812) 676-43-65
s-petersburg@conmet.ru

г. Краснодар
350063, Советская ул, 30
офис 1103
Тел. (861) 268-14-08
krasnodar@conmet.ru

г. Тула
300005
Ул. Ликбеза, 18
Тел. (915) 690-00-85
tula@conmet.ru

г. Хабаровск
680030, Постышева ул, 22А
офис 401
Тел. (4212) 41-51-72
khabarovsk@conmet.ru

г. Владивосток
690091, Океанский проспект, д. 17
оф. 503/1
Тел. (423) 265-00-64
vladivostok@conmet.ru

г. Самара
443001, ул. Молодогвардейская, д. 204,
офис 102
Тел. (917) 949-75-21
samara@conmet.ru

г. Новосибирск
630007, Октябрьская магистраль ул, 4
офис 112
Тел. (383) 240-99-09
novosibirsk@conmet.ru

г. Екатеринбург
620075, Ленина ул, 50Б
офис 313
Тел. (343) 272-32-56
(922) 033-78-85
ekaterinburg@conmet.ru

CONMET

Система дентальных имплантатов
Ортопедический протокол

Вариабельность высоты трансгингивальной части супраструктур

обеспечивает оптимальное десневое прилегание.

Сочетание конуса и шестигранника[1]

обеспечивает максимальную точность позиционирования и минимальную микроподвижность соединения супраструктура – имплантат.

Агрессивная резьба

позволяет быстро и надежно установить имплантат в костную ткань.

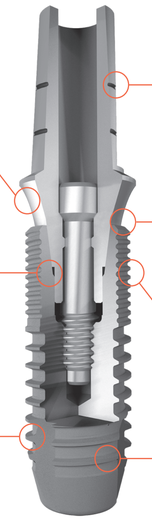

Мерные риски

облегчают адаптацию цементируемых головок по высоте.

Функция «переключения платформ»

обеспечивает минимальную резорбцию кости и максимальный эстетический эффект.

Микрорезьба

способствует оптимальному распределению нагрузки на кортикальный слой, обеспечивая его минимальную резорбцию.

Биоактивное покрытие

способствует ускоренной регенерации кости и уменьшает сроки остеоинтеграции.

[1] Соединение успешно прошло усталостные испытания по ISO 14801 (5 млн. циклов).

Вы можете заказать для Вашей CAD/CAM системы:

- головки для сканирования (scan abatment) с интерфейсом КОНМЕТ
- заготовки для фрезерования индивидуальных абатментов (Pre-mill) с интерфейсом КОНМЕТ

Имплантаты

Измеритель слизистой | Формирователи десны | Трансферы слепочные (для закрытой ложки / для открытой ложки) | Аналоги имплантатов | Головки прямые цементируемые | Головки угловые цементируемые (10°, 20°) | Головки разъемные прямые | Головки разъемные угловые (17°, 30°) | Головки универсальные моделируемые | Головки обтачиваемые | Головки сферические | Дубликаторы (пластиковые) | Временные головки

Винт фиксирующий M1.6



Цилиндрический

d 3.5 — L 8 | 10 | 12 | 14 | 16 — N. 215.00 | 01 | 02 | 03 | 04

d 4.0 — L 8 | 10 | 12 | 14 | 16 — N. 215.10 | 11 | 12 | 13 | 14

Конический

D 4.4/d 3.4 — L 8 | 10 | 12 | 14 | 16 — N. 217.00 | 01 | 02 | 03 | 04

платформа 4.0 / платформа 5.0 — 2.25











Винт фиксирующий M1.8

Цилиндрический

d 4.5 — L 8 | 10 | 12 | 14 | 16 — N. 215.20 | 21 | 22 | 23 | 24

d 5.0 — L 8 | 10 | 12 | 14 | 16 — N. 215.30 | 31 | 32 | 33 | 34

d 5.5 — L 8 | 10 | 12 | 14 | 16 — N. 215.40 | 41 | 42 | 43 | 44

Конический

D 4.8/d 3.8 — L 8 | 10 | 12 | 14 | 16 — N. 217.10 | 11 | 12 | 13 | 14

D 5.5/d 4.5 — L 8 | 10 | 12 | 14 | 16 — N. 217.20 | 21 | 22 | 23 | 24

платформа 5.0 / платформа 6.5 — 2.75



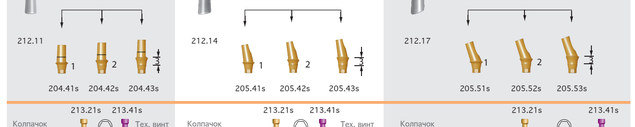



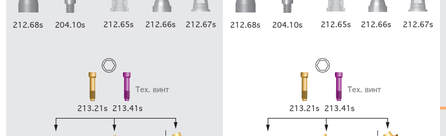









Винт фиксирующий M1.8

Цилиндрические короткие

d 5.0 — L 6.5 — N. 215.60

d 5.5 — L 6.5 — N. 215.70

d 6.0 — L 6.5 — N. 215.80

платформа 5.0 / платформа 6.5 — 2.75



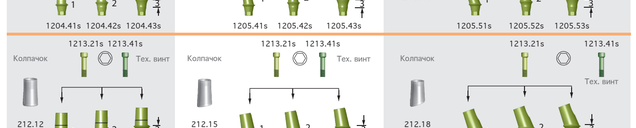



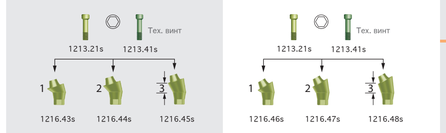









Винт фиксирующий M2



Классический

d 4.0 — L 8 | 10 | 12 — N. 202.82 | 83 | 84
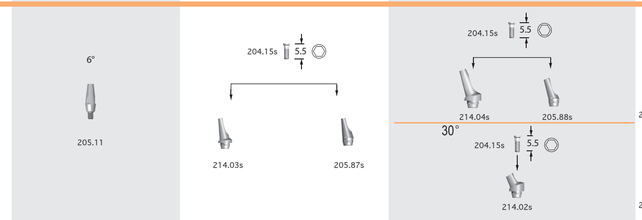
d 4.8 — L 8 | 10 | 12 — N. 248.82 | 83 | 84